


Opšta bolnica
Petrovac na Mlavi
Broj: BV6/01-254/1
Dana : 11.12.2014.

Predmet: Pojašnjenje konkursne dokumentacije u JN
Laboratorijskog potrošnog materijala br. BV6/01-2014
Partija 3 Reagensi za hemostazu – Trombotrack select 2

Potencijalni ponuđač je zahtevao dodatno objašnjenje konkursne dokumentacije i to:

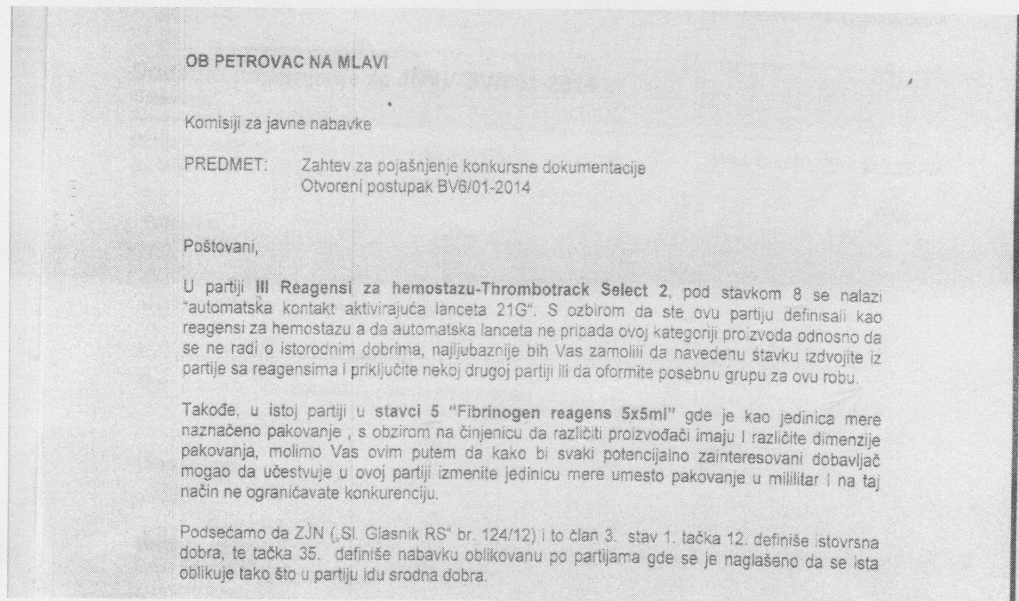

Naručilac je partiju 3. Reagensi za hemostazu – TROMBOTRACK SELECT 2, stavka 5. "Fibrinogen reagens 5x5ml" formirao na osnovu saznanja da na tržištu ima više ponuđača koji su u stanju da ponude istovrsna dobra od kojih je formirana partija.

U konkursnoj dokumentaciji pod tačkom 3.1.vrsta tehničke karakteristike (specifikacije) naručilac je obavezao ponuđače da: "U slučaju razlike u pakovanju ponuđenog dobra u odnosu na pakovanje navedeno u obrascu ponude ponuđač je dužan da preračuna cenu ponuđenog dobra na traženo pakovanje u obrascu ponude."

Ponuđači su dužni da u ponudi cenu iskažu po traženim jedinicama mere – pakovanje (1 pakovanje = 25 ml).

Komisija za javnu nabavku naručioca oblikovala je partije na osnovu više posebnih istovrsnih celina tj. postojeće opreme (aparata) koju Opšta bolnica Petrovac na Mlavi koristi.

Komisija za javnu nabavku smatra da izmena konkursne dokumentacije – Obrasca ponude – partije br.3 nije opravdana, jer stavka 8. Automatska kontakt aktivirajuća lanceta 21 G predstavlja istovrsno dobro sa ostalim artiklima u pomenutoj partiji.

Lanceta je adekvatno sredstvo za uzimanje materijala za određivanje analize i u direktnoj je vezi sa dobijanjem ispravnih rezultata.

Predsednik Komisije za javnu nabavku
Načelnik laboratorije
Dragana Nešić Parežanin s.r.

